


Obr. 2. Mobilní aplikace pro zaslání EKG z chytrých hodinek do telemedicínského centra**Obr. 3.** Dálková monitorace implantabilního zařízení prostřednictvím mobilní aplikace

Použití technologie Bluetooth Low Energy, s minimalizací spotřeby baterie implantátu



Zvýšené zabezpečení dat šifrováním

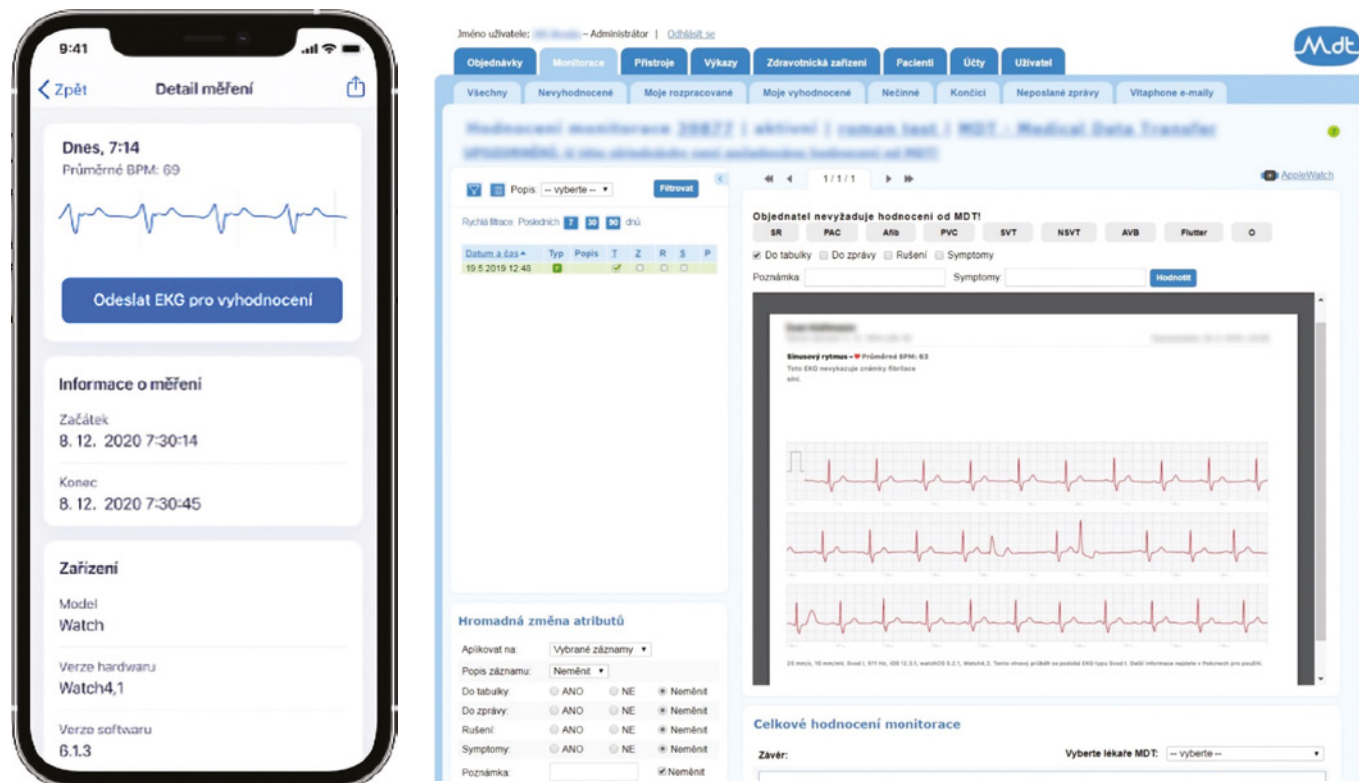

Doživotní možnost upgradu Pacientského zařízení



Automatická upozornění informují pacienty o stavu přenosu