


Obr. 1. Upraveno dle (6)



BHR – bronchiální hyperreaktivita, DC – dýchací cesty. Vysvětlivky barev: červená: chabé důkazy, žlutá: diskutabilní, zelená: dostatečné důkazy

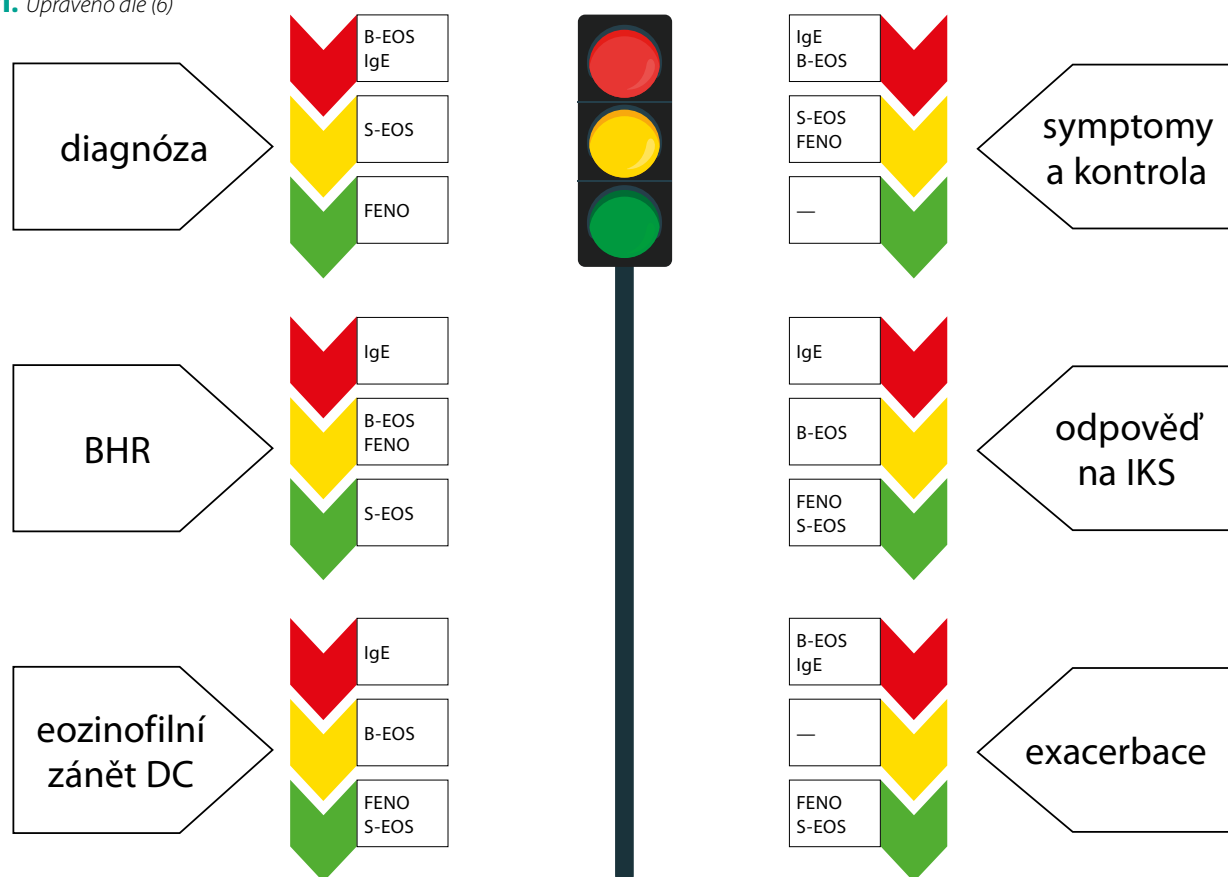

QuickSeal

Váš specialista na POCT přístroje a rychlou diagnostiku

Jasná volba pro lékaře a pacienty

Jedinečný systém Vivatmo

Měření FeNO - metoda pro monitoring léčby astmatu



BOSCH

Stvořeno pro život

Vivatmo pro

- ▶ Navrženo pro profesionální použití.
- ▶ Snadné měření díky intuitivnímu vedení uživatele a vizuální animaci.
- ▶ Flexibilita: bezkabelové zařízení a indukční způsob napájení.
- ▶ Bezúdržbový systém: po celou dobu životnosti přístroje není nutná kalibrace.
- ▶ Snadné použití a intuitivní ovládání pro okamžité a spolehlivé výsledky.



Vivatmo me

- ▶ Určeno i pro domácí použití (pro sebetestování).
- ▶ Přenosné, uživatelsky přívětivé zařízení se snadno stane součástí každodenního života pacientů.
- ▶ Pravidelné měření FeNO dává pacientům cenné informace o průběhu onemocnění.
- ▶ Výsledek je zobrazen ihned po dokončení měření. Červená, oranžová a zelená barva značí úroveň změřené hodnoty FeNO.
- ▶ Flexibilita: bezkabelové zařízení na baterie



První certifikovaný přístroj pro domácí použití.

Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. Reklama je určena pro odborníky. Pozorně si přečtěte návod k použití. Použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena. © 2023 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. Datum vydání 9/2023